


编号: YNH/AJ-15-13-2024

样本稀释液出厂检验报告

检验日期: 2026.01.27 试剂批号: 22601231
样品型号: 22601 商家地址/电话: 13800000000
试剂规格: 1L、20L
设备信息:

仪器名称	血小板分析仪	PH计	电导率仪	冰点渗透压
检测原理	阻抗法	玻璃电极法	电导率法	冰点下降法
检测范围	10-1000×10 ⁹ /L	6.5-12.5	0-1000μS/cm	-1.90-0.90℃

检测项目	要求	检测结果				结果判定 合格(√) / 不合格(×)
		检测1	检测2	检测3	均值	
外观	澄清透明, 无可见杂质, 颜色一致	符合要求				√
装量	不低于标示量	20.05L	20.05L	20.05L	20.05L	√
pH值	6.5-7.5 (25℃)	7.15	7.15	7.15	7.15	√
电导率	25℃时, 1750±150μS/cm	1720	1750	1780	1750	√
冰点渗透压	-1.90±0.05℃	-1.92	-1.90	-1.88	-1.90	√
结论	检测结果合格	合格				√

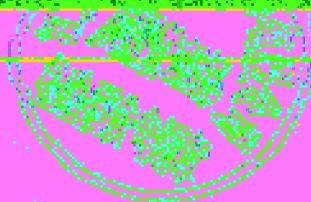

检测人: 张明 复核人: 李华 审核人: 王强 日期: 2026.01.27